取扱説明書

株式会社島津理化　　100-848

鉛 イ オ ン 選 択 電 極（ＩＳＥ）

Lead Ion Selective Electrode

CI-6736

ご使用に際しての安全上の注意事項

●この取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。
●いつでも取扱説明書が使用できるように大切に保管してください。
●当社では誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を，次のように規定しています。

⚠ 注 意	誤った取り扱いをすると，人が傷害を負ったり，物的損害の発生が想定される内容を示します。
注　記	機器を正しく使用していただくための情報を示しています。

絵表示の意味

	この絵表示は，禁止事項を示しています。 この絵表示の近くに，具体的な禁止内容を表記しています。

安全上の注意

⚠　注　　意

	電極本体の樹脂や，検出子と電極の接着を侵す有機化合物を含むサンプルや疎水性のサンプルは，測定しないでください。また，極性の高い溶媒を含むサンプルも，ゆっくりと電極を侵し，寿命が短くなるので測定しないでください。

１．はじめに

この度は,『鉛イオン選択電極 CI-6736』をお買い上げいただきまことにありがとうございます。

鉛イオン選択電極は，エポキシ樹脂に接着された硫化鉛と硫化銀の薄膜からなり，薄膜が鉛イオンを含んだ溶液と接触すると，溶液中のイオン濃度に応じて電極の電位差が発生します。鉛イオン選択電極を，別途用意した ISE/ORP アンプとインターフェイスに接続してこの電極電位を測定すれば，あらかじめ作成した検量線からイオン濃度を算出することができます。

２．製品構成

① 鉛イオン選択電極 ..... 1 本
② 充填溶液ボトル ..... 1 本
③ 充填用ピペット ..... 1 本
④ 研磨紙 ..... 1 枚
⑤ 取扱説明書（本書） ..... 1 部

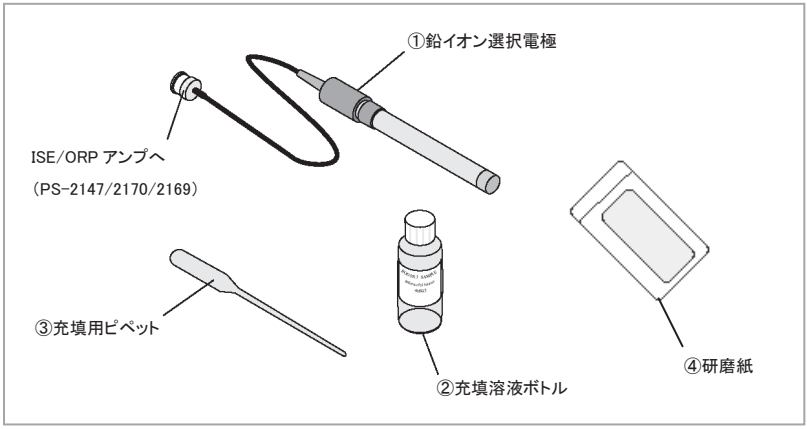

図 1　製品構成

本製品での測定に別途必要なセンサ（ISE/ORP アンプとして機能する下記いずれか）

・100-819 pH/温度センサ PS-2147
・100-730 マルチ化学センサ PS-2170
・100-733 マルチ水質センサ PS-2169

３．電極仕様

測定可能濃度範囲	1×10^{-6}M ～ 1×10^{-1}M
pH 範囲	3 ～ 8
温度範囲	0 ～ 80℃
抵抗	1 MΩ
再現性	±2%
本体寸法	φ12mm×110mm
ケーブル長さ	1m

４．測定理論

測定した電極電位と溶液中のイオン活量との関係は，ネルンストの式で表されます。

$$E = E_0 + S\log X$$

ここで，

E ＝ 測定した電極電位

E_0 ＝ 基準電位（定数）

S ＝ 比例係数（検量線の傾き）

X ＝ 溶液中イオン活量

全イオン濃度 C_t は，自由イオン C_f と，錯体化または結合したイオン C_b の総和であり，電極はこの自由イオンのみに応答することができます。自由イオンの濃度は次のように表されます。

$$C_f = C_t - C_b$$

活量 X と自由イオン濃度 C_f の関係は，活量係数 γ によって次のように示されます。

$$X = \gamma C_f$$

この活量係数 γ は全イオン強度 I によって変化し，この I は以下のように定義されます。

$$I = \frac{1}{2}\Sigma C_X Z_X{}^2$$

ここで，

C_x ＝ イオン X の濃度

Z_x ＝ イオン X の電荷

Σ ＝ 溶液中のあらゆるタイプのイオンの総和

測定対象以外のイオンの中に，イオン強度が一定で，多種に比べて圧倒的に大きいものがある場合，全イオン強度はほぼそのイオンの強度によって決まり，一定となります。（測定対象イオンの強度には依存しません。）

このとき，活量係数 γ も一定となりますので，ネルンストの式は以下のように変形できます。

$$E = E_0 + S\log X$$
$$= E_0 + S\log \gamma C_f$$
$$= E_0 + S\log \gamma + S\log C_f$$

ここで $E_0 + S\log\gamma$ を新たに定数 E_0 とすれば，以下の式が成り立ちます。

$$E = E_0 + S\log C_f$$

５．実験の準備

5.1 電極

1）鉛イオン選択電極の先端部を覆っているゴム製キャップを取り外します。

2）スリーブをずらし，ピペットを用いて充填溶液を充填穴に入れます。

3）イオン選択電極を ISE/ ORP アンプに接続します。

4）ISE/ORP アンプをインターフェイスに接続します。

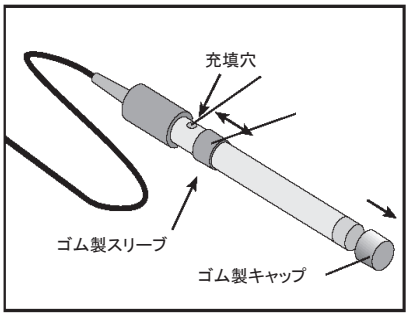

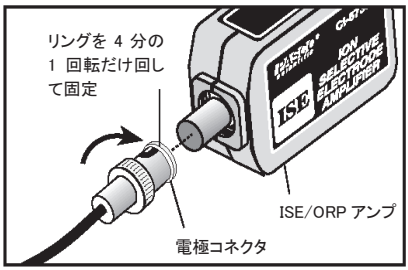

図２ 電極の準備

5.2 各種溶液

溶 液 名	溶 媒	溶 質
イオン強度調整剤(ISA) 5 M $NaClO_4$	蒸留水 1000mL	・過塩素酸ナトリウム 700g
過塩素酸鉛標準液 0.1M $Pb(ClO_4)_2$	蒸留水 1000mL	・過塩素酸鉛 46.01g

６． 電極の校正

6.1 校正液の測定

1） 標準液から低濃度（C_L=10^{-4}M）の校正液 100mL を希釈して用意し，2mL の調整剤と共にビーカーに入れ，マグネチックスターラで撹拌します。

2） 電極を校正液に浸し，ISE 電圧（電極電圧）の表示が安定したら，その値（E_L）を記録します。

3） 標準液から高濃度（C_H=10^{-3}M）の校正液 100mL を希釈して用意し，2mL の調整剤と共にビーカーに入れ，マグネチックスターラで撹拌します。

4） 電極を校正液に浸し，ISE 電圧表示が安定したら，その値（E_H）を記録します。

6.2 検量線の傾きと基準電位の計算

低濃度校正液と高濃度校正液の濃度と電圧の関係は，以下のように表すことができます。

$$E_L = E_o + S\log C_L$$

$$E_H = E_o + S\log C_H$$

ここで E_0は基準電位を示します。

比例係数 S（=検量線の傾き）は以下のように表すことができます。

$$E_H - E_L = S\log\left(\frac{C_H}{C_L}\right)$$

$$\therefore \text{傾き } S = \frac{E_H - E_L}{\log\left(\frac{C_H}{C_L}\right)}$$

求めた傾きから，基準電位 E_0を求めることができます。

$$E_o = E_L - S\log C_L$$

この測定から得られる代表的な検量線を以下に示します。

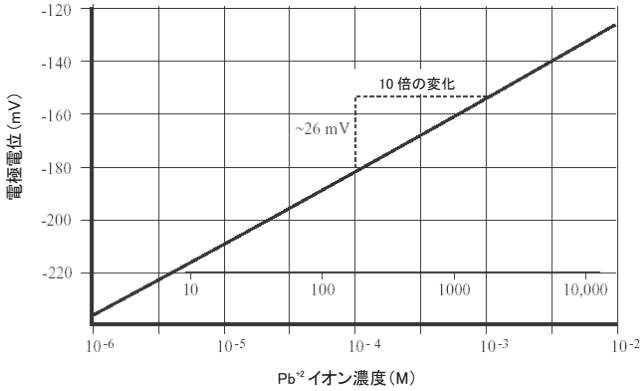

図３ 鉛電極の代表的な検量線

注　記	検量線が直線となる領域内であれば，上記で求めた傾き S と基準電位 E_0そして測定電圧 E から，計算によりサンプル溶液の濃度 C を求めることができます。したがって，片対数グラフ用紙を用いた検量線の作成は必ずしも必要はありません。 $$イオン濃度\ C = 10^{\left(\frac{E-E_0}{S}\right)}$$ また，この計算式は SPARK PS−2008A などのデータロガーにあらかじめ入力することにより，自動的にイオン濃度が算出されるファイルを作成することができます。詳しい入力方法はデータロガーの取扱説明書をご覧ください。

７．サンプル溶液の測定

1）測定するサンプル溶液 100mL を用意し，2mL の調整剤と共にビーカーに入れ，マグネチックスターラで撹拌します。

2）電極を校正液に浸し，ISE 電圧表示が安定したら，その値（E ）を記録します。

3）イオン濃度 C を計算により求めるか，データロガー上に測定値を表示します。

注　記	測定におけるヒント ・ 精密に測定するためには，すべてのサンプルと校正液を同じ温度にする必要があります。温度に 1℃の差があると，おおよそ 2%の測定誤差が出ます。 ・ 正確な測定を行うためには，丁寧に攪拌し続けることが必要です。マグネチックスターラには，溶液温度を変化させるほどの熱が発生することがあります。この影響を和らげるために，薄い発泡スチロールのような断熱材を 1 枚，マグネチックスターラとビーカーの間に入れます。 ・ 測定後は電極を蒸留水ですすぎ，拭いて乾燥させます。拭き取りには，拭き取り用のタオル等のきれいな紙や布を使用して薄膜の汚染を防ぎます。 ・ イオン強度の高いサンプルを測定するときは，サンプル溶液にイオン組成が似た（濃度が既知の）標準液を作って検量線を引き直してから測定してください。また，濃度が 0.1M 以上の場合には，サンプルを希釈して測定してください。 ・ 電極を校正液やサンプル溶液に浸した後，薄膜に気泡が付着していないことを必ず確認してください。

８．電極の特性

8.1 再現性

電極の校正を 1 時間ごとに行えば，電極の測定値の再現性は±2%程度に収まります。気温の変動，ドリフト，ノイズなどの要因により，再現性には限界があります。電極の動作範囲内では再現性は濃度に依存しません。

8.2 干渉

強い還元溶液中では金属銀の層が形成されることがあります。また，サンプル中に不溶解塩を形成するほどの高レベルのイオンが存在する時，薄膜上に銀の塩が析出することがありますが，研磨によって性能を回復することができます。

鉛イオン選択電極は陰イオンと多くの陽イオンには反応しませんが，銅，水銀，銀を含んだ溶液は電極膜に汚染されてしまいます。したがって，これらのイオンが存在する場合，測定はできません。

もし，鉄イオンやカドミウムイオンの濃度が鉛イオンの濃度よりも低い場合には，干渉は起きません。逆に鉄イオンやカドミウムイオンのレベルが鉛イオンのレベルよりも高い場合には，干渉が起き，測定値に誤差が生じます。鉄イオンによる干渉は，NaOH を加えて pH 値を 4 より上にした時に消去することができます。

8.3 沈殿や錯体による影響

硫酸イオン，リン酸イオン，水酸化物イオンなどは，鉛と結合すると不溶解性の塩になって沈殿します。沈殿となる割合は，鉛イオンの濃度，沈殿したイオンの濃度，pH によって決まります。酢酸，アンモニア，アミノ酸，クエン酸，EDTA などは，鉛イオンと結合して錯体を形成します。錯体化が起こる割合は，鉛の全濃度，錯体の全濃度，溶液の pH，イオン強度によって変化します。沈殿や錯体が生成すると，自由鉛イオンの濃度が低下します。電極は自由鉛イオンにのみ反応しますので，沈殿や錯体が生成すると，正確な測定ができません。

8.4 温度の影響

電極の電位は温度変化の影響を受けるため，サンプルと校正液は同じ温度にする必要があります。10^{-3}M のレベルで，1℃の温度差は 2%の誤差を引き起こします。電極の基準電位やネルンストの式中の“S”で示される検量線の傾きは温度によって変化します。

検量線の傾きに関する温度と理論値

温度［℃］	“S”
0	54.20
10	56.18
20	58.16
25	59.16
30	60.15
40	62.13
50	64.11

8.5 電極の応答

電極電位の安定した読み取り値の 99%に達するまでに要する時間，すなわち電極応答時間は，高濃度溶液での数秒から検出限界近くでの数分まで様々です。

8.6 ｐＨの影響

図 4 はさまざまな pH レベルにおける溶液中の鉛イオンに対する電極反応を示します。鉛イオン濃度を干渉なしで測定できる最低 pH 値は，図中の左の影で示されています。

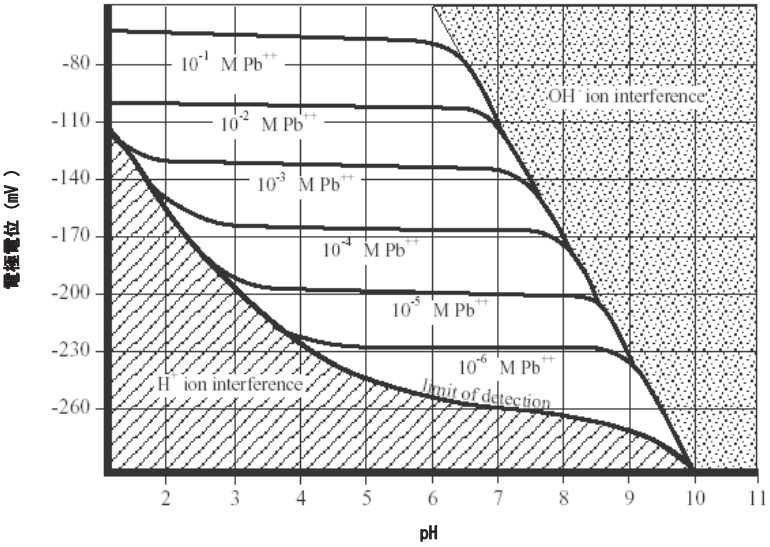

図４　電極電位に対する $Pb(ClO_4)_2$ 溶液の pH 値

8.7 電極の寿命

電極の寿命は，通常の実験での使用で約 6 ヶ月です。長時間の連続測定を行うと，稼動寿命が短くなり 2，3 ヶ月になることもあります。応答時間が長くなり，校正が困難になるほど検量線の傾きが小さくなった場合は，電極の交換が必要になります。

９．保守・管理

9.1 電極の保管

鉛電極は，10^{-2}M の鉛溶液に入れて短期間保管することができます。2 週間を越える長期保管の場合は，薄膜を蒸留水ですすぎ乾燥させ，出荷時に同梱している保護キャップを先端部に被せます。もし，詰め替え用の充填溶液があれば，電極から使用済みの充填溶液を抜き，充填穴にゴム製スリーブを取り付けて保管します。

9.2 薄膜の研磨

電位読み値のドリフトや検量線の傾きの減少が起きたときには，電極薄膜の研磨が必要です。研磨手順は以下の通りです。

1）研磨紙を使う場合，約 3cm 角に切り取り，表面を上にして実験台の上に置きます。
2）数滴の蒸留水もしくは脱イオン水を研磨紙の中央に落とします。
3）片手で研磨紙をしっかりと押さえ，電極薄膜を垂直に研磨紙に持っていきやさしく回転させながら数秒間研磨します。
4）電極表面を蒸留水もしくは脱イオン水ですすぎ，標準溶液に約 5 分間浸します。

製品安全データシート

製品名称	鉛イオン選択電極 充填溶液 Reference Fill Solution, 1M KNO_3
製品 No	100-848
製造者	Van London pHoenix Company 6103 Glenmont Dr. Houston, Texas 77081
輸入・販売者 緊急連絡先	株式会社 島津理化 京都事業所　技術課 604-8445　京都市中京区西ノ京徳大寺 1 番地 TEL:075-823-2815 FAX:075-823-2804
製品説明	イオン選択電極に充填し，電極電位を得るために使用する，付属溶液である。
組成および成分	CAS 7757-79-1　硝酸カリウム　含有率 10% CAS 7732-18-5　蒸留水　含有率 90%
物理的性質	沸点: 104°C 比重: 1.1 蒸気圧: N/A 凝固点: −4°C 蒸気密度: N/A pH: 5.5 ～ 8 溶解性: 可溶性 外観/臭い: 無色，無臭 引火点：引火しない 安定性：安定 混触危険物質：還元物，B，BaS，Na アセテート，Ti，S，トリクロロエチレン，チャコール 危険有害な分解生成物：窒素酸化物
暴露による影響	皮膚，傷口，目に付着した場合，刺激を引き起こすことがある。
注意事項 	【安全対策】 取扱い後はよく手を洗うこと。この製品を使用する時に，飲食または喫煙をしないこと。粉じん，ヒューム，蒸気，スプレーを吸入しないこと。環境への放出を避けること。 【応急措置】 飲み込んだ場合，口をすすぐこと。気分が悪い時は，医師に連絡すること。眼に入った場合，水で数分間注意深く洗うこと。次に，コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合は，医師の診断，手当てを受けること。気分が悪い時は，医師の診断，手当てを受けること。漏出物を回収すること。 【保管】 製品状態を維持するため，キャップを確実に閉め，室温にて保管すること。 【廃棄】 自治体の廃液処理基準に従うこと。
関連法規	化審法 分類：既存物質，官報公示整理番号：1-449

MEMO

© Copyright 2011 株式会社島津理化

株式会社島津理化

〒136-0071　東京都江東区亀戸６丁目１番８号
TEL.（03）5626-6600　　URL：http://www.shimadzu-rika.co.jp

本製品の技術的お問合せは，コールセンターまで
フリーダイヤル　0120-376-673（携帯電話，PHS ではご利用になれません。）
受付時間　平日 9：00～12：00，13：00～17：00
e-mail：soudan@shimadzu-rika.co.jp　　FAX：（075）823-2804

M100848D1111TY001-A